



ZytoLight

SPEC VHL/CEN 3 Dual Color Probe

REF Z-2084-200

20 (0.2 ml)

Pro kvalitativní detekci deleci lidského genu VHL a alfa satelitů chromozomu 3 fluorescenční *in situ* hybridizací (FISH)



Prostředek pro lékařskou in vitro diagnostiku
V souladu s EU nařízením 98/79/EC

3. Princip testu


Fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci a vizualizaci specifických sekvencí nukleových kyselin v buněčných preparátech. Fluorescenčně označené úseky DNA, tzv. FISH próby, a jejich komplementární cílové úseky DNA v preparátech jsou společně denaturovány a následně je umožněno jejich spárování v průběhu hybridizace. Poté jsou nespecifické a nenačíslované fragmenty prob odstraněny pomocí důkladných oplachovacích kroků. Po dobarvení DNA pomocí DAPI jsou hybridizované úseky DNA vizualizovány pomocí fluorescenčního mikroskopu vybaveného excitačními a emisními filtry specifickými pro fluorochromy, se kterými byly FISH próby označeny.

4. Potřebné reagencie

ZytoLight SPEC VHL/CEN 3 Dual Color Probe se skládá z:

- ZyGreen (excitace 503 nm/ emise 528 nm) označené polynukleotidy (~10.0 ng/μl), s cílovými sekvencemi v 3p25.3* (chr3:10,051,220-10,598,496) nesoucí VHL genovou oblast (viz Obr.1).
- ZyOrange (excitace 547 nm/ emise 572 nm) označené polynukleotidy (~1.5 ng/μl), s cílovými sekvencemi v 3p11.1-q11.1 specifické pro alfa satelitní centromerickou oblast D3Z1 chromozomu 3.
- Hybridizační pufr založený na formamidu

* V souladu s knihovnou lidského genomu GRCh37/hg19

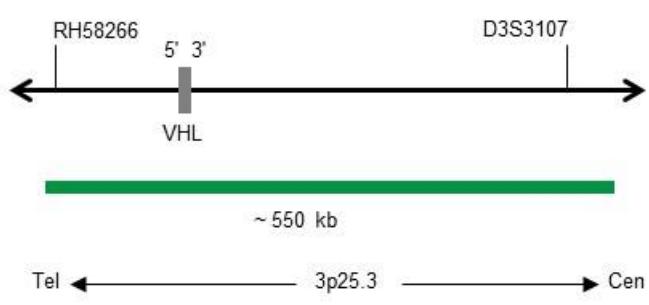

Obr. 1: SPEC VHL Mapa sondy (mimo měřítko)

ZytoLight SPEC VHL/CEN 3 Dual Color Probe dostupný v jedné velikosti:

- Z-2084-200: 0.2 ml (20 reakcí po 10 μl každá)

5. Vybavení, které je vyžadováno, ale není součástí dodávky

- ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Prod. No. Z-2028-5/-20)
- Positivní a negativní kontrolní vzorky
- Mikroskopická sklíčka, pozitivně nabité
- Vodní lázeň (37°C, 98°C)
- Hybridizér nebo vyhříváná ploténka
- Hybridizér nebo vlnká komůrka v hybridizační troubě
- Pipety (10 μl, 25 μl)
- Stopky
- Barvičí nádoby nebo lázně
- Kalibrovaný teploměr
- Xylen
- Ethanol (alkohol)
- Deionizovaná nebo destilovaná voda
- Krycí sklíčka (22 x 22 mm, 24 x 60 mm)
- Lepidlo, např. Fixogum Rubber Cement (Katalog.č. E-4005-50/-125) nebo podobné
- Fluorescenční mikroskop s odpovídajícím vybavením (400 - 1000x)
- Imerzní olej určený pro fluorescenční mikroskop
- Odpovídající sada filtrů

1. Použití

ZytoLight SPEC VHL/CEN 3 Dual Color Probe (PL43) je určen k použití pro kvalitativní detekci deleci lidského genu VHL a alfa satelitů chromozomu 3 formalinem fixovaných, v parafinech zalýchých vzorků jmetodou fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH). Próba je určená k použití v kombinaci s ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Prod. No. Z-2028-5/-20).

Interpretace výsledků musí být prováděna kvalifikovaným patologem, v kontextu s klinickou historií pacienta a s ohledem na ostatní klinické a patologické nálezy.

2. Klinický význam

Nádorový supresorový gen VHL (von Hippel-Lindau tumorový supresor) je umístěn na 3p25.3 a kóduje 30 kDa protein s aktivitou ubikvitin ligázy E3. Protein se podílí na ubikvitinaci a degradaci hypoxií indukovatelného faktoru (HIF), což je transkripční faktor, který hraje kritickou roli v regulaci genové exprese kyslíkem.

Ztráta heterozygotnosti (LOH) na chromozomu 3p a inaktivace genu VHL delecí nebo mutací je nejčastější genetickou změnou u sporadických i konvenčních rendních karcinomů spojených s onemocněním VHL (RCC), zatímco změny této oblasti jsou zřídka pozorovány u papilárního a chromofobního RCC.

Nedávné studie naznačují, že stanovení stavu VHL pomocí fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH) může významně zlepšit přesnost hodnocení biopsie nádoru ledviny a poskytnout prognostické informace, které mohou vést k rozhodnutí o léčbě.

6. Skladování a zacházení

Skladujte při teplotě 2-8 °C, ve vzpřímené pozici, chráněné před sluncem. Používejte chráněné před sluncem. Vratě do skladovacích podmínek okamžitě po použití. Nepoužívejte reagencie po uplynutí doby expirace uvedené na štítku.

7. Varování a preventivní opatření

- Před použitím si přečtěte instrukce!
- Nepoužívejte reagencie po uplynutí doby expirace!
- Tento produkt obsahuje látky (v nízkých koncentracích a objemech), které jsou škodlivé pro zdraví a potenciálně infekční. Vyvarujte se přímého kontaktu s reagenciami. Používejte přiměřené ochranné prostředky (jednorázové rukavice, ochranné brýle a laboratorní pláště).
- V případě kontaktu s kůží omyjte okamžitě velkých množstvím vody!
- Pro profesionální uživatele je na vyžádání dostupný bezpečnostní list.
- Nepoužívejte reagencie opakovaně.
- Vyvarujte se vzájemné kontaminace vzorů, neboť to může vést k chybám výsledkům.
- Próba by neměla být po delší dobu vystavena světu, speciálně ne silnému světu, tzn., že všechny kroky by se měly provádět ve tmě a/nebo za použití tmavých, světlé nepropouštějících nádobek.

Rizika:

Složka určující riziko je formamid.



Nebezpečí

| | |
|-----------|--|
| H351 | Podezření na vyvolání rakoviny. |
| H360FD | Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanej expoziči. |
| P201 | Před použitím si obstarejte speciální instrukce. |
| P202 | Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jím. |
| P260 | Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. |
| P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejoj šířit. |
| P308+P313 | PŘI expoziči nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
| P405 | Skladujte uzamčené. |

8. Omezení

- Pouze pro *in vitro* diagnostiku.
- Pouze pro profesionální uživatele.
- Klinická interpretace jakéhokoliv pozitivního barvení nebo jeho chybění musí být hodnocena v kontextu klinické historie, morfologie, ostatních histopatologických kritérií a stejně tak i ostatních diagnostických testů. Je odpovědností kvalifikovaného patologa být obeznámený s FISH próbami, reagencemi, diagnostickými panely a metodami používanými k barvení preparátů. Barvení musí být prováděno v certifikované, licencované laboratoři pod dozorem patologa, který je odpovědný za prohlížení obarvených skel a vyhodnocení odpovídající pozitivních a negativních kontrol.
- Barvení preparátu, obzvláště intenzita a barvení pozadí závisí na zacházení se vzorkem před barvením. Neodpovídající fixace, mražení, tání, oplachování a sušení, var, krájení nebo kontaminace jinými vzorky nebo tekutinami může vést k artefaktům nebo falešným výsledkům. Nekonzistentní výsledky mohou být výsledkem variacemi ve fixaci a prosycovacích metodách, stejně tak jako nepravidelnostmi uvnitř vzorku.

- Próba má být používána pouze pro detekci lokusů popsaných v odstavci 4.
- Barvení bylo validováno za použití metod popsaných v těchto instrukcích pro použití. Obměny těchto procedur mohou vést ke změnám barvení a mají být validovány uživatelem.

9. Interferující látky

Pokud jsou ve vzorku přítomny červené krvinky, mohou jevit autofluorescenci, která ztěžuje detekci hledaných signálů

Následující fixační tekutiny jsou nekompatibilní (nevzhodné) pro FISH:

- Bouinův roztok
- B5 fixace
- Kyselá fixativa (např. kys. pikrová)
- Zenkerova fixační tekutina
- Alkoholy (pokud jsou používány samostatně)
- Chlorid rtuti
- Formaldehyd/zinkové fixativum
- Hollandovo fixativum
- Nepufrovaný formalín

10. Příprava vzorků

- Fixace v 10% neutrálním pufrovaném formalínu po dobu 24h při pokojové teplotě (18-25°C).
- Připravte tkáňové vzorky $\leq 0,5 \text{ m}^3$.
- Používejte parafín nejvyšší (prémiové) kvality.
- Prosycení by mělo být prováděno při teplotě nižší než 65°C.
- Připravte řezy o tloušťce 2-4 μm .
- Používejte pozitivně nabité skla.
- Fixujte po dobu 2-16h při teplotě 50-60°C.

11. Příprava před použitím

Produkt je ready-to-use, tedy připraven k přímému použití. Není vyžadována žádná obnova, mísení nebo ředění. Před použitím přineste proubu do pokojové teploty (18-25 °C), chraňte před světem. Před otevřením nádobky promíchejte krátce ve vortexu a stočle.

12. Pracovní postup

Příprava vzorku

Připravte vzorek podle instrukcí uvedených u [ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit](#).

Denaturace a hybridizace

1. Napipepujte 10 μl próby na každý předpřipravený vzorek.
 2. Přikryjte vzorky krycím sklíčkem 22 mm x 22 mm (vyvarujte se vytvoření bublin) a zalepte krycí sklíčko.
- Doporučujeme použít speciální lepidlo např. Fixogum.*
3. Umístěte skla na horkou ploténku nebo do hybridizéru a denaturujte vzorky 10 min při 75°C.
 4. Přeneste skla do vlhké komůrky nebo hybridizujte přes noc při 37 °C (např. v hybridizační troubě).

Je zcela zásadní, aby vzorky v průběhu hybridizačního kroku nevyschlly.

Post-hybridizace

Posthybridizační kroky (oplach, dobarvení, fluorescenční mikroskopie) provádějte podle instrukcí uvedených v [ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit](#).


13. Interpretace výsledků

Při použití vhodných sad filtrů se hybridizační signály sondy jeví zeleně (VHL genová oblast) a oranžově (CEN 3).

Normalní situace: V interfázích normálních buněk nebo buněk bez delece zahrnující oblast genu VHL se objeví dva oranžové signály a dva zelené signály (viz obrázek č.2).

Abnormální situace: V buňce s delecí ovlivňující oblast genu VHL bude pozorován snížený počet zelených signálů. Delece ovlivňující pouze části oblasti genu VHL mohou vést k normálnímu signálovému vzoru se zelenými signály zmenšené velikosti (viz obrázek č.2).

Překrývající se signály se mohou jevit jako žluté signály.

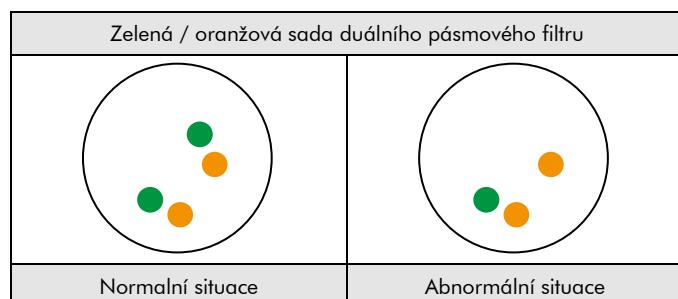

Obr. Č. 2 : Předpokládaný normální výsledek a abnormální jádra

Jiná distribuce (rozmístění) signálů může být pozorována v některých abnormálních vzorcích, která může vést ve výsledku k jinému vzoru signálů, než jsou popsány výše, indikující variantní přestavby. Nečekané vzory signálů by měly být dále dovyšetřeny.

Vemte v potaz:

- Kvůli rozvolněnému chromatinu se mohou jednotlivé signály jevit jako malé shluky signálů. A proto dva nebo tři signály stejné velikosti, které jsou ve vzdálenosti, která je menší než průměr jednoho signálu, mají být počítány jako jeden signál.
- Nehodnotte překrývající se jádra.
- Nepočítejte příliš natrávená jádra (rozpoznatelná podle přítomnosti tmavých oblastí uvnitř jader).
- Nepočítejte jádra se silnou autofluorescencí, která znesnadňuje rozpoznání signálů.
- Negativní nebo neočekávaný výsledek může být způsoben vícečetnými faktory, viz odst. 17.
- Za účelem správného hodnocení výsledků musí uživatel před použitím produktu provést validaci v souladu s národními a/nebo mezinárodními doporučeními.

14. Doporučené postupy kontroly kvality

Za účelem zajištění správných postupů má být ke každému testu přiřazena vnitřní a vnější kontrola. Pokud tyto kontroly selžou při demonstraci správného barvení, výsledky vzorku pacienta musí být hodnoceny jako invalidní.

Vnitřní kontrola: Nenádorové buňky uvnitř vzorku, ve kterých je patrný normální vzor signálů.

Externí kontrola: Ověřené (validované) pozitivní a negativní kontrolní vzorky.

15. Výkonnostní charakteristiky

Přesnost: Místo hybridizace sondy bylo hodnoceno na metafázových spreadech karyotypově normálního samce. Ve všech testovaných vzorcích hybridizovala sonda pouze na očekávané lokusy. Nebyly pozorovány žádné další signály nebo křížové hybridizace. Proto byla vypočítána přesnost na 100%.

Analytická citlivost: Pro analytické stanovení citlivosti byla sonda vyhodnocena na metafázových spreadech karyotypicky normálních samců. Všechna jádra ukázala očekávaný normální signál ve všech testovaných vzorcích. Analytická citlivost byla proto vypočtena na 100%.

Analytická specificita: Pro stanovení analytické specificity byla sonda vyhodnocena na metafázových spreadech karyotypicky normálních samců. Ve všech testovaných vzorcích hybridizovaly všechny signály pouze s očekávanými cílovými lokusy a žádnými jinými lokusy. Analytická specificity byla proto vypočtena na 100%.

16. Likvidace odpadů

Likvidace reagencí musí být provedena v souladu s lokálními zákony.

17. Řešení problémů

Jakákoliv odchylka od návodu k obsluze může vést k horším výsledkům barvení nebo k žádnému znečištění.

Slabé nebo vůbec žádné signály

| Možná příčina | Řešení |
|--|--|
| Žádné dostupné cílové sekvence | Použijte vhodnou kontrolu. |
| Buňky nebo tkán nebyly fixovány správně | Optimalizujte fixační čas nebo aplikujte postfixační kroky popsaných v kapitole 12 „Pracovní postup“ v návodu ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit |
| Nesprávná příprava teplom, natrávení, denaturace, hybridizace nebo teplota oplachu | Zkontrolujte teplotu u vše zařízení, u kterých je kalibrovaný teplomér |
| Proteolytická předběžná úprava není řádně provedena | Optimalizujte inkubační dobu pepsinu, Zvýšte nebo snižte. |
| Odpárování sondy | Při použití hybridizéru, je nutné použít mokré proužky / nádrže naplněné vodou. Při použití hybridizační pece, vhlé komoty, by mělo být krycí sklíčko zcela uzavřené, např Fixogum, aby se zabránilo vysýchaní vzorků během hybridizace |
| Příliš nízká koncentrace promývacího pufru | Zkontrolujte koncentraci promývacího pufru |
| Staré odvodňovací roztoky | Připravte čerstvé odvodňovací roztoky. |
| Špatné nastavení fluorescenčního mikroskopu | Nastavte správně |
| IPoužití nesprávného setu filtrů | Použijte set filtrů, které jsou odpovídající fluochromům próby. <i>Trojitý filtr poskytuje méně světla v porovnání s jednoduchými nebo duálními filtry. Navíc signály se mohou při použití trojitého filtru jevit bledší.</i> |
| Poškození próby světlem | Hybridizační a promývací kroky provádějte ve tmě. |

Zkrácené hybridizační signály, šum na pozadí

| Možná příčina | Řešení |
|--|--|
| Nekompletní odparafinování | Použivejte čerstvé roztoky; zkontrolujte délku odparafinování |
| Příliš silné natrávení | Zkrátte inkubaci s pepsinem. |
| Příliš velký objem próby na plochu vzorku | Snižte objem próby na řez, rozmostříte proužek po kapkách, abyste se vyhnuli příliš vysoké místní koncentraci. |
| Preparáty jsou vychladlé na pokojovou teplotu před hybridizací | Přenechte preparáty krátce do 37 °C |
| Příliš vysoká koncentrace promývacího pufru | Zkontrolujte koncentraci promývacího pufru. |
| Oplachovací teplota po hybridizaci je příliš nízká | Zkontrolujte teplotu a zvýšte ji, pokud je to nutné |
| Vysušení vzorků mezi jednotlivými kroky inkubace | Zabraňte vysušení pomocí přilepení krycího sklíčka a provádění inkubace ve vlhkém prostředí. |

Poškozená morfologie

| Možná příčina | Řešení |
|--|---|
| Buňky nebo tkáň nebyly fixovány správně | Optimalizujte fixační čas nebo aplikujte postfixační kroky popsaných v kapitole 12 „Pracovní postup“ v návodu <u>ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit</u> |
| Příprava natravením není provedena správně | Optimalizujte dobu inkubace s pepsinem, zkrátte nebo prodlužte, je-li potřeba |
| Nedostatečné oschnutí preparátu na vzdachu před aplikací práby | Prodlužte osušení. |

Překrývání jader

| Možná příčina | Řešení |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nevhodná tloušťka tkáňových řezů | Připravte 2-4 µm microtomové řezy. |

Vzorek uplavává ze sklíčka

| Možná příčina | Řešení |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nevhodný povrch sklíčka | Použijte vhodná sklíčka. |
| Natrávení je příliš silné | Snižte inkubační dobu pepsinu |

Slabé barvení

| Možná příčina | Řešení |
|--------------------------------|---|
| Nízká koncentrace roztoku DAPI | Používejte DAPI/DuraTect-Solution (ultra) (Prod. No. MT-0008-0.8) |
| Příliš krátká doba inkubace | Prodlužte dobu inkubace s DAPI. |

18. Literatura

- Barocas DA, et al. (2006) *BJU Int* 99: 290-5.
- Broom RJ, et al. (2012) *Clin Genitourin Cancer* 10: 202-6.
- Dagher J, et al. (2013) *Hum Pathol* 44: 2106-15.
- Hosoe S, et al. (1990) *Genomics* 8: 634-40.
- Kievits T, et al. (1990) *Cytogenet Cell Genet* 53: 134-6.
- Latif F, et al. (1993) *Science* 260: 1317-20.
- Sükösd F, et al. (2003) *Cancer Res* 63: 455-7.
- Wilkinson DG: *In Situ Hybridization, A Practical Approach*, Oxford University Press (1992) ISBN 0 19 963327 4.

Naši experti jsou Vám k dispozici zodpovědět Vaše otázky. Prosím kontaktujte helptech@zytovision.com



ZytoVision GmbH
Fischkai 1
27572 Bremerhaven/Německo
Telefon: +49 471 4832-300
Fax: +49 471 4832-509
www.zytovision.com
Email: info@zytovision.com

Ochranná známka:

ZytoVision® a ZytoLight® jsou pod ochrannou známkou ZytoVision GmbH.