



## ZytoDot 2C SPEC 19q13/19p13 Probe

|     |            |   |             |
|-----|------------|---|-------------|
| REF | C-3037-100 | Σ | 10 (0,1 ml) |
| REF | C-3037-400 | Σ | 40 (0,4 ml) |

Kromojenik *in situ* hibridizasyon (CISH) ile insan kromozomu 19q13.32-q13.33 delesyonlarının ve 19p13.3 spesifik sekanslarının kalitatif tespiti için

4250380P124QQ



In vitro diagnostik tıbbi cihaz  
IVDR (AB) 2017/746'ya göre

### 1. Hedeflenen amaç

ZytoDot 2C SPEC 19q13/19p13 Probe (PD22), insan kromozomal bölgesi 19q13.32-q13.33 içeren delesyonların yanı sıra glioma gibi formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü örneklerde kromozom 19p13.3'e özgü sekansların kromojenik *in situ* hibridizasyon (CISH) yoluyla kalitatif tespiti için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Probu ZytoDot 2C CISH Implementation Kit (Ürün No. C-3044-10/-40) ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

Ürün sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Ürünün kullanıldığı tüm testler sertifikalı, lisanslı bir anatomik patoloji laboratuvarında bir patolog/insan genetikçisinin gözetimi altında kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Probu gliomun ayırıcı tanısına yardımcı olarak kullanılması amaçlanmıştır ve terapötik önlemler yalnızca test sonucuna göre başlatılmamalıdır.

### 2. Test prensibi

Kromojenik *in situ* hibridizasyon (CISH) tekniği, hücre preparatlarında spesifik nükleik asit dizilerinin tespit edilmesini ve görüntülenmesini sağlar. CISH problemleri olarak adlandırılan hapten-ışaretili nükleotid fragmanları ve preparatlardaki tamamlayıcı hedef dizileri birlikte denatüre edilir ve daha sonra hibridizasyon sırasında tavlama işlemine izin verilir. Daha sonra, spesifik olmayan ve bağlanmamış prob parçaları sıkı yıkama adımları ile uzaklaştırılır. İşaretili probun dubleks oluşumu, ikincil polimerize enzim-konjuge antikörler tarafından tespit edilen birincil (ışaretsiz) antikörler kullanılarak görselleştirilebilir. Kromojenik substratlarla enzimatik reaksiyon, renkli çöktürmelerin oluşmasına yol açar. Çekirdeğin bir nükleer boya ile karşı boyanmasından sonra, hibridize prob parçaları ışık mikroskobu ile görselleştirilir.


### 3. Sağlanan reaktifler

ZytoDot 2C SPEC 19q13/19p13 Probe oluşmaktadır:

- Digoksigenin ile işaretlenmiş polinükleotitler (~0,8 ng/μl) içinde eşlenen dizileri hedefleyen 19p13.3\* (chr19:815,938-962,244) (bkz. Şekil 1).
- Dinitrofenil işaretli polinükleotitler (~0,8 ng/μl) içinde eşlenen dizileri hedefleyen 19q13.32-q13.33\* (chr19:47,857,776-48,339,398) (bkz. Şekil 1).

Formamid bazlı hibridizasyon tamponu

\*İnsan Genomu Düzenlemesine göre GRCh37/hg19

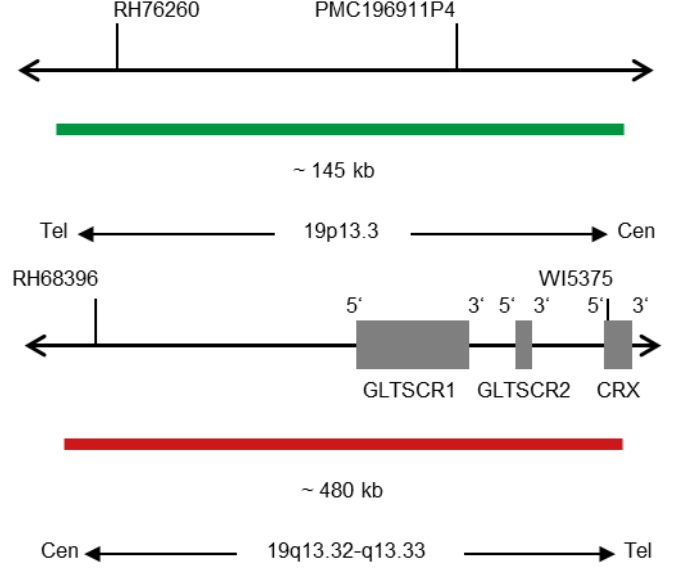

Şekil 1: Üst: SPEC 19p13 Prob haritası, Alt: SPEC 19q13 Prob haritası (ölçekli değil)

ZytoDot 2C SPEC 19q13/19p13 Probe iki boyutta mevcuttur:

- C-3037-100: 0,1 ml (her biri 10 μl'lik 10 reaksiyon)
- C-3037-400: 0,4 ml (her biri 10 μl'lik 40 reaksiyon)

### 4. Gerekli ancak sağlanmayan malzemeler

- ZytoDot 2C CISH Implementation Kit (Ürün No. C-3044-10/-40)
- Pozitif ve negatif kontrol numuneleri
- Mikroskop lamaları, pozitif yüklü
- Su banyosu (80 °C, 98 °C)
- Hibridizatör veya sıcak plaka
- Hibridizasyon fırınında hibridizatör veya nem odası
- Ayarlanabilir pipetler (10 μl, 1000 μl)
- Boyama kavanozları veya banyoları
- Zamanlayıcı
- Kalibre edilmiş termometre
- Etanol veya reaktif alkol
- Ksilen
- Metanol %100
- Hidrojen peroksit (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) %30
- Deiyonize veya damıtılmış su
- Kapaklı Klipsler (22 mm x 22 mm, 24 mm x 32 mm)
- Kauçuk çimento, örneğin, Fixogum Rubber Cement (Ürün No. E-4005-50/-125) veya benzeri
- Yeterince bakımı yapılmış ışık mikroskobu (400-630x)

### 5. Depolama ve taşıma

2-8 °C'de dik konumda saklayın. Kullanımdan hemen sonra saklama koşullarına geri döndürün. Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra reaktifleri kullanmayın. Ürün, uygun şekilde kullanıldığında etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

## 6. Uyarılar ve önlemler

- Kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun!
- Reaktifleri son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın!
- Bu ürün sağlığa zararlı ve potansiyel olarak bulaşıcı maddeler (düşük konsantrasyonlarda ve hacimlerde) içerir. Reaktiflerle doğrudan temastan kaçının. Uygun koruyucu önlemleri alın (tek kullanımlık eldivenler, koruyucu gözlükler ve laboratuvar giysileri kullanın)!
- Ürünle ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olayı yerel yönetmeliklere uygun olarak üreticiye ve yetkili makama bildirin!
- Reaktifler ciltle temas ederse, cildi derhal bol miktarda suyla yıkayın!
- Profesyonel kullanıcılar için talep üzerine bir malzeme güvenlik bilgi formu temin edilebilir.
- Tekrar kullanıma açıkça izin verilmediği sürece reaktifleri tekrar kullanmayın!
- Hatalı sonuçlara yol açabileceğinden numunelerin çapraz kontaminasyonundan kaçının.
- Hibridizasyon ve yıkama adımları sırasında numunelerin kurummasına izin verilmemelidir.

### Tehlike ve önlem beyanları:

Tehlikeyi belirleyen bileşen formamiddir.



#### Tehlike

|           |  |
|-----------|--|
| H351      | Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor.                                       |
| H360FD    | Doğurganlığa zarar verebilir. Doğmamış çocuğa zarar verebilir.                 |
| H373      | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. |
| P201      | Kullanmadan önce özel talimatları alın.  |
| P202      | Tüm güvenlik önlemleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.                       |
| P260      | Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumayın.                                       |
| P280      | Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.            |
| P308+P313 | Maruz kaldıysanız veya endişeliyseniz: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.            |
| P405      | Depo kilitle.  |

## 7. Sınırlamalar

- *In vitro* diagnostik kullanım için.
- Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Yalnızca otomatik olmayan kullanım içindir.
- Herhangi bir pozitif boyamanın klinik yorumu veya yokluğu, klinik öykü, morfoloji, diğer histopatolojik kriterler ve diğer tanısal testler bağlamında yapılmalıdır. CISH problemleri, reaktifleri, tanı panelleri ve boyalı preparatı üretmek için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak kalifiye bir patolog/insan genetikçisinin sorumluluğundadır. Boyama, boyanmış slaytları gözden geçirmekten ve pozitif ve negatif kontrollerin yeterliliğini sağlamaktan sorumlu olan bir patolog/insan genetikçisinin gözetimi altında sertifikalı, lisanslı bir laboratuvarında yapılmalıdır.
- Numune boyaması, özellikle sinyal yoğunluğu ve arka plan boyaması, boyamadan önce numunenin kullanımına ve işlenmesine bağlıdır. Uygun olmayan fiksasyon, dondurma, çözdürme, yıkama, kurutma, ısıtma, kesit alma veya diğer numuneler veya sıvılarla kontaminasyon artefaktlara veya yanlış sonuçlara neden olabilir. Tutarsız sonuçlar, fiksasyon ve gömme yöntemlerindeki farklılıkların yanı sıra numune içindeki doğal düzensizliklerden de kaynaklanabilir.

- Prob sadece bölüm 3'te açıklanan lokusları tespit etmek için kullanılmalıdır. "Sağlanan reaktifler".
- Performans, bu kullanım talimatlarında açıklanan prosedürler kullanılarak doğrulanmıştır. Bu prosedürlerde yapılacak değişiklikler performansı değiştirebilir ve kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır. Bu IVD, yalnızca bu kullanım talimatında açıklandığı şekilde amaçlanan kullanım kapsamında kullanıldığında CE sertifikasına sahiptir.

## 8. Müdahale eden maddeler

Aşağıdaki fiksatifler ISH ile uyumlu değildir:

- Bouin'in fiksatif
- B5 fiksatif
- Asidik fiksatifler (örn. pikrik asit)
- Zenker fiksatif
- Alkoller (tek başına kullanıldığında)
- Merkürük klorür
- Formaldehit/çinko fiksatif
- Hollandé'nin sabitleyicisi
- Tamponlanmamış formalin

## 9. Numunelerin hazırlanması

Örnekleri ZytoDot 2C CISH Implementation Kit kullanım talimatlarında açıklandığı şekilde hazırlayın.

## 10. Cihazın hazırlık işlemi

Ürün kullanıma hazırdır. Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez. Kullanmadan önce probu oda sıcaklığına (18-25 °C) getirin, ışıktan koruyun. Flakonu açmadan önce vorteksleyerek karıştırın ve kısa bir süre döndürün.

## 11. Tahlil prosedürü

### Numune ön işlemi

ZytoDot 2C CISH Implementation Kit kullanım talimatlarına göre numune ön işlemini (örn. mum alma, proteoliz) gerçekleştirin.

### Denatürasyon ve hibridizasyon

1. Ön işlemden geçirilmiş her numuneye 10 µl prob pipetleyin.
  2. Örnekleri 22 mm x 22 mm lamel ile kaplayın (sıkışmış kabarcıklardan kaçının) ve lameli kapatın.
- Sızdırmazlık için kauçuk çimento (örn. Fixogum) kullanmanızı öneririz.*
3. Lamaları sıcak bir plakaya veya hibridizatöre yerleştirin ve örnekleri 79 °C'de 5 dakika boyunca denatüre edin.
  4. Lamaları bir nem odasına aktarın ve gece boyunca 37 °C'de hibridize edin (örn. bir hibridizasyon fırınında).

*Hibridizasyon adımı sırasında numunelerin kurumaması çok önemlidir.*

### Hibridizasyon sonrası


Hibridizasyon sonrası işlemleri (yıkama, tespit, karşı boyama, montaj, mikroskop) ZytoDot 2C CISH Implementation Kit kullanım talimatlarına göre gerçekleştirin.

## 12. Sonuçların yorumlanması

ZytoDot 2C CISH Implementation Kit kullanıldığında, Digoxigenin ile işaretlenmiş polinükleotidlerin hibridizasyon sinyalleri koyu yeşil renkli belirgin noktalar (19p13 lokusu) ve Dinitrofenil ile işaretlenmiş polinükleotidler parlak kırmızı renkli belirgin noktalar (19p13 lokusu) olarak görünür.

**Normal durum:** Normal hücrelerin veya 19p13 lokusunu içeren delesyonu olmayan hücrelerin interfazlarında, iki farklı nokta şeklinde kırmızı ve iki farklı nokta şeklinde yeşil sinyal görülür (bkz. Şekil 2).

**Anormal bir durum:** 19p13 lokusunu etkileyen delesyona sahip bir hücrede, kırmızı sinyallerin sayısında azalma gözlenecektir. 19p13 lokusunun sadece bir kısmını etkileyen delesyonlar, boyutu küçülmüş kırmızı sinyallerle normal bir sinyal modeline neden olabilir (bkz. Şekil 2).

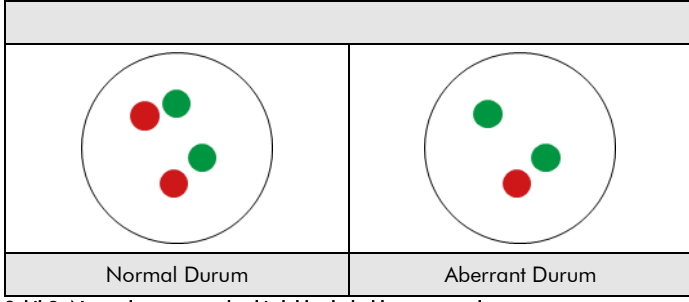

Şekil 2: Normal ve anormal çekirdeklere beklenen sonuçlar

Bazı anormal numunelerde yukarıda açıklananlardan farklı sinyal modelleri gözlemlenebilir. Bu beklenmedik sinyal modelleri daha fazla araştırılmalıdır.

#### Lütfen unutmayın:

- Dekondense kromatin nedeniyle, tek CISH sinyalleri küçük sinyal kümeleri olarak görünebilir. Bu nedenle,  $\leq 1$  sinyal çapı mesafeyle ayrılmış aynı boyuttaki iki veya üç sinyal tek bir sinyal olarak sayılmalıdır.
- Sinyal sayımından önce, numune 100 ila 200 kat büyütme ile olası intratümöral heterojenite açısından taranmalıdır.
- Sinyallerin görselleştirilmesi en az 400 kat büyütme ile yapılmalı ve kolayca görülebilen sinyaller elde edilmelidir. Kromozomal kırılmaları tespit eden problemler için 630 kat büyütme önerilir. Sinyal rengini bozabileceğinden kontrast artırıcı filtre lensleri kullanmayın. Parlak renklerde sinyaller elde etmek için diyafram açıklığını açın. Bir çekirdeği değerlendirirken yukarı ve aşağı odaklandığınızdan emin olun, çünkü kırmızı ve yeşil sinyaller birbirinin üzerinde bulunabilir.
- Nekroz alanlarını, üst üste binen çekirdekleri, aşırı sindirilmiş çekirdekleri ve zayıf sinyal yoğunluğuna sahip çekirdekleri değerlendirmeyin.
- Mitoz nedeniyle, neoplastik olmayan hücrelerin küçük bir yüzdesinde bile ek sinyaller görülebilir. Bazen, parafine gömülü örneklerde kesme artefaktları nedeniyle eksik sinyalli çekirdekler gözlemlenebilir.
- Negatif veya spesifik olmayan bir sonuç birden fazla faktörden kaynaklanabilir (bkz. Bölüm 16 "Sorun Giderme").
- Sonuçların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için, kullanıcı bu ürünü tanı prosedürlerinde kullanmadan önce ulusal ve/veya uluslararası kılavuzlara göre doğrulamalıdır.

### 13. Önerilen kalite kontrol prosedürleri

İşlenmiş numunelerin ve test reaktiflerinin doğru performansını izlemek için, her tahlile dahili ve harici kontroller eşlik etmelidir. Dahili ve/veya harici kontroller uygun boyamayı gösteremezse, hasta numuneleriyle elde edilen sonuçlar geçersiz kabul edilmelidir.

**Dahili kontrol:** Örnek içinde normal sinyal paterni sergileyen neoplastik olmayan hücreler, örneğin fibroblastlar.

**Harici kontrol:** Onaylanmış pozitif ve negatif kontrol numuneleri.

### 14. Performans özellikleri

#### 14.1 Analitik performans

Proben performansı, ilgili IVD onaylı FISH probu ile karşılaştırılarak belirlenmiştir.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Analitik hassasiyet:</b> | 100% (95% CI 98.5 – 100.0) |
| <b>Analitik özgüllük:</b>   | 100% (95% CI 97.0 – 100.0) |

Günden Güne Tekrar Üretilebilirlik, bir denetçinin 10 farklı günde elde ettiği sonuçları karşılaştırarak ve uyumu değerlendirilerek test edilmiştir.

|                 | Yüzde Anlaşma |
|-----------------|---------------|
| nnegatif numune | 100%          |
| pozitif numune  | 100%          |

Tekrarlanabilirlik, bir denetçiden 10 farklı günde elde edilen tekrarlanan sonuçlar karşılaştırılarak ve uyum değerlendirilerek test edilmiştir.

|                 | Yüzde Anlaşma |
|-----------------|---------------|
| nnegatif numune | 100%          |
| pozitif numune  | 100%          |

#### 14.2 Klinik performans

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tanısıl duyarlılık:</b> | 100% (95% CI 91.4 – 100.0) vs. FISH |
| <b>Teşhis özgüllüğü:</b>   | 100% (95% CI 91.4 – 100.0) vs. FISH |

### 15. Bertaraf

Reaktiflerin imhası yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

### 16. Sorun Giderme

Kullanım talimatlarından herhangi bir sapma, düşük boyama sonuçlarına veya hiç boyama olmamasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen [www.zyfovvision.com](http://www.zyfovvision.com) adresine bakın.

#### Zayıf sinyaller veya hiç sinyal yok

| Olası neden                                      | Eylem   |
|--|---|
| Proteolitik ön işlem düzgün yapılmamış           | Pepsin inkübasyon süresini optimize edin, gerekirse artırın veya azaltın  |
| Buharlaştırma probu                              | Bir hibridizatör kullanırken, ıslak şeritlerin/su dolu tankların kullanılması zorunludur. Bir hibridizasyon fırını kullanıldığında, bir nem odasının kullanılması gereklidir. Ayrıca, hibridizasyon sırasında numunenin kurumasını önlemek için lamel, örneğin Fixogum ile tamamen kapatılmalıdır |
| Karşı boyama süresi çok uzun                     | Koyu karşı boyamadan kaçının, çünkü pozitif boyama sinyallerini gizleyebilir  |
| Karşı lekenin mavileştirilmesi düzgün yapılmamış | Mavileştirme için soğuk akan musluk suyu kullanın; ılık veya sıcak su veya mavileştirme reaktifleri kullanmayın   |

#### Sinyaller çok güçlü

| Olası neden  | Eylem   |
|--|---|
| Proteolitik ön işlemin çok uzun sürmesi            | Pepsin inkübasyon süresini optimize edin, gerekirse artırın veya azaltın  |
| AP-Kırmızı Çözeltili inkübasyon süresi doğru değil | Gerekirse inkübasyon süresi 5 dakikaya kadar kısaltılabilir. Substrat çözeltisini 25 °C'nin üzerinde ısıtmayın; sadece oda sıcaklığında inkübe edin |
| HRP-Green çözeltili inkübasyon süresi doğru değil  | Gerekirse inkübasyon süresi 7 dakikaya kadar kısaltılabilir. Substrat çözeltisini 25 °C'nin üzerinde ısıtmayın; sadece oda sıcaklığında inkübe edin |

#### Kırmızı sinyaller çok zayıf

| Olası neden  | Eylem  |
|--|--|
| AP-Kırmızı Çözeltili güçlü ışığa maruz bırakıldı   | AP-Red Solüsyonunu güçlü doğrudan ışıktan koruyarak hazırlayın ve kullanın |
| AP-Kırmızı Çözeltili çok erken hazırlandı          | Hemen kullanmadan önce hazırlayın  |
| AP-Kırmızı Çözeltili inkübasyon süresi doğru değil | Gerekirse, inkübasyon süresi 15 dakikaya kadar uzatılabilir                |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Kromojenik substratın yetersiz hazırlanması | Çözelti A'nın hacmini artırmayın |
|---|----------------------------------|

**Yeşil sinyaller çok zayıf**

| Olası neden   | Eylem   |
|---|---|
| HRP-Green ile boyamadan sonra herhangi bir yıkama adımının inkübasyon süresi çok uzun | Verilen inkübasyon sürelerini aşmayın                       |
| HRP-Green çözeltisi inkübasyon süresi doğru değil                                     | Gerekirse, inkübasyon süresi 15 dakikaya kadar uzatılabilir |
| Kromojenik substratın yetersiz hazırlanması   | Çözelti A'nın hacmini artırmayın                            |

**Sinyaller kaybolur veya birleşir**

| Olası neden                                    | Eylem   |
|--|---|
| Uygun olmayan bir montaj çözümü kullanılmıştır | Yalnızca kitle birlikte verilen montaj solüsyonunu veya herhangi bir yabancı madde içermeyen ksilen bazlı montaj solüsyonlarını kullanın; lamel bandı kullanmayın |
| Kesitler uygun şekilde dehidrate edilmemiş     | Taze etanol ve ksilen çözeltileri kullanın; yalnızca "saf" kalitede ksilen kullanın   |

**Düzensiz veya bazı kısımlarda sadece çok hafif lekelenme**

| Olası neden             | Eylem   |
|-------------------------|---|
| Eksik mum alma          | Taze solüsyonlar kullanın; mum alma sürelerini kontrol edin               |
| Reaktif hacmi çok küçük | Reaktif hacminin doku alanını kaplayacak kadar büyük olduğundan emin olun |

**Tutarsız sonuçlar**

| Olası neden  | Eylem  |
|--|--|
| Prob uygulamasından önce yetersiz kurutma  | Hava ile kurutmayı uzatın  |
| Pepsin, antikorlar ve/veya renk substratlarının uygulanmasından önce doku üzerinde çok fazla su/yıkama tamponu | Fazla sıvının doku kesitinden lekeleyerek veya lamdan sallayarak uzaklaştırıldığından emin olun. Az miktarda kalan su/yıkama tamponu testi etkilemez |
| Doku fiksasyonu ve gömme yöntemlerindeki varyasyonlar  | Sabitleme ve gömme yöntemlerini optimize edin  |
| Doku kesit kalınlığındaki değişimler   | Kesit almayı optimize edin   |

**Morfoloji bozulmuş**

| Olası neden  | Eylem   |
|--|---|
| Hücre veya doku örneği uygun şekilde sabitlenmemiş | Sabitleme süresini ve fiksatifini optimize edin |
| Proteolitik ön işlemin çok uzun süre yapılmaması   | Pepsin inkübasyon süresini azaltın              |

**Çapraz hibridizasyon sinyalleri; gürültülü arka plan**

| Olası neden   | Eylem  |
|---|--|
| Hibridizasyon sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda kurumuş kesitler | Kesitlerin kurumasını önleyin; nem odası kullanın; lamelleri uygun şekilde kapatın |
| Uzatılmış substrat inkübasyon süresi  | Substrat inkübasyon süresini kısaltın  |
| Eksik mum alma  | Taze solüsyonlar kullanın; mum alma süresini kontrol edin                          |
| Proteolitik ön işlem çok güçlü  | Pepsin inkübasyon süresini optimize edin   |
| Hibridizasyondan önce oda sıcaklığına soğutulmuş slaytlar                     | Lamları hızlı bir şekilde hibridizasyon sıcaklığına aktarın                        |

**Çakışan sinyaller**

| Olası neden                               | Eylem                                |
|---|--------------------------------------|
| Doku kesitlerinin uygun olmayan kalınlığı | 3-5 µm mikrotom kesitleri hazırlayın |

**Numune lam üzerinde yüzer**

| Olası neden                    | Eylem                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proteolitik ön işlem çok güçlü | Pepsin inkübasyon süresini kısaltın |

**17. Edebiyat**

- Lass U, et al. (2013) *Brain Pathol* 23: 311-8.
- Wilkinson DG: In Situ Hybridization, A Practical Approach, *Oxford University Press* (1992) ISBN 0 19 963327 4.

**18. Revizyon**

| Revizyon | Onaylanmış kuruluş değişikliği   |
|----------|--|
| 5.1.1    | Onaylanmış kuruluş değişikliği<br>14. Performans özellikleri doğruluk ekleme |



[www.zytovision.com](http://www.zytovision.com)

En güncel kullanım talimatları ve farklı dillerdeki kullanım talimatları için lütfen [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com) adresine bakın.

Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlamak için hazırdır. Lütfen [helptech@zytovision.com](mailto:helptech@zytovision.com) ile iletişime geçin. Güvenlik ve performans özeti için lütfen bkz. [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com).



ZytoVision GmbH  
Fischkai 1  
27572 Bremerhaven/ Almanya  
Telefon numarası: +49 471 4832-300  
Faks: +49 471 4832-509  
[www.zytovision.com](http://www.zytovision.com)  
E-posta: [info@zytovision.com](mailto:info@zytovision.com)

**Ticari markalar:**

ZytoVision® ve ZytoDot®, ZytoVision GmbH'nin ticari markalarıdır.